

ALGIMED TECHNO СЕРИЯ 012024В ДАТА ИЗГОТОВЛЕНИЯ 29.01.2024 ГОДЕН ДО 29.07.2025	ПАСПОРТ КАЧЕСТВА №	38
	НАБОР РЕАГЕНТОВ	ИФА антибиотик -бацитрацин
	СВЕДЕНИЯ О НД	ТУ ВУ 193208315.001-2019

Таблица 1. Критерии приемлемости результатов


«Диапазоны допустимых значений для V/V_0 , %»

Компоненты набора	Серия	Годен до
Микротитровальный планшет	023	17.09.2025
Градуировочные растворы	023	19.09.2025
Конъюгат	023	26.09.2025
ТМБ-субстрат	023	25.09.2025
Стоп-реагент	023	21.12.2026
5-ти кратный концентрат буферного раствора для разбавления проб	023	18.09.2025
20-ти кратный концентрат промывочного раствора	023	04.08.2025

Градуировочные растворы (мкг/л)	Диапазон V/V_0 , %
0.00	100%
0.60	75-97 %
1.50	55-80 %
4.50	40-65 %
13.50	19-40 %
40.00	10-35 %

1. Отношение оптической плотности градуировочных растворов V/V_0 , % должно соответствовать диапазону допустимых значений, приведенных в таблице 1.
2. Значение оптической плотности первого градуировочного раствора с концентрацией 0 мкг/л должно быть не менее 0,9 оптических единиц.
3. Коэффициент вариации CV (%) для двух параллельных измерений каждого градуировочного раствора не должен превышать 10%.

Калибровочная кривая

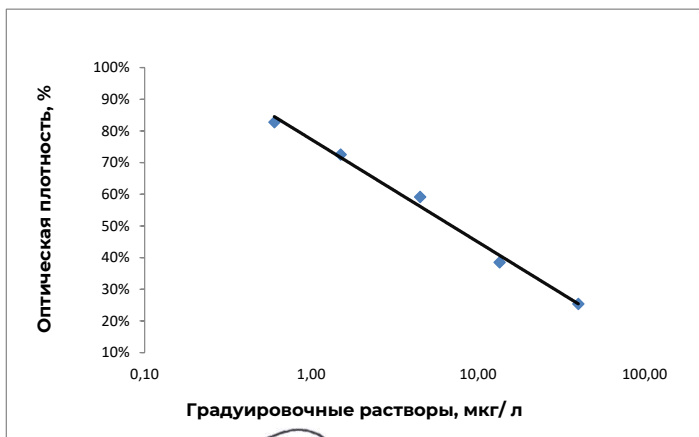

Специалист по контролю качества



Заключение: продукт соответствует требованиям ТУ ВУ 193208315.001-2019

Дата выдачи паспорта:

30.01.2024

**ALGIMED
TECHNO**

т. +375 29 893 14 44

algimed@algimed.com

Сайт: algimed-techno.com

ООО "Альгимед Техно"
220090, Республика Беларусь,
г. Минск, тр. Логойский, д.22,
корп.1, ком. 309