

<h1>ALGIMED TECHNO</h1> <p>СЕРИЯ 122023 ДАТА ИЗГОТОВЛЕНИЯ 29.12.2023 ГОДЕН ДО 29.06.2025</p>	ПАСПОРТ КАЧЕСТВА №	277
	НАБОР РЕАГЕНТОВ	ИФА антибиотик -бацитрацин
	СВЕДЕНИЯ О НД	ТУ ВУ 193208315.001-2019

Таблица 1. Критерии приемлемости результатов
«Диапазоны допустимых значений для В/В₀, %»

Компоненты набора	Серия	Годен до
Микротитровальный планшет	022	19.08.2025
Градуировочные растворы	022	21.08.2025
Конъюгат	022	26.08.2025
ТМБ-субстрат	022	15.08.2025
Стоп-реагент	022	04.12.2026
5-ти кратный концентрат буферного раствора для разбавления проб	022	15.08.2025
20-ти кратный концентрат промывочного раствора	022	04.08.2025

Градуировочные растворы (мкг/л)	Диапазон В/В ₀ , %
0.00	100%
0.60	75-97 %
1.50	55-80 %
4.50	40-65 %
13.50	19-40 %
40.00	10-35 %

1. Отношение оптической плотности градуировочных растворов В/В₀, % должно соответствовать диапазону допустимых значений, приведенных в таблице 1.
2. Значение оптической плотности первого градуировочного раствора с концентрацией 0 мкг/л должно быть не менее 0,9 оптических единиц.
3. Коэффициент вариации CV (%) для двух параллельных измерений каждого градуировочного раствора не должен превышать 10% .

Калибровочная кривая

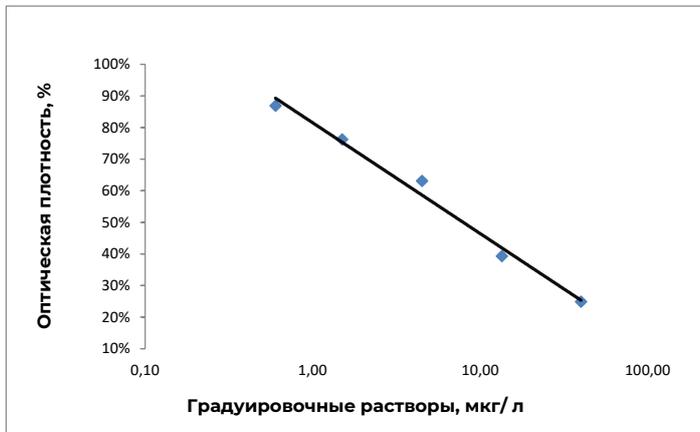


Таблица 2. Данные контроля качества набора

Градуировочные растворы (мкг/л)	Оптическая плотность, ДВ 450 нм	В/В ₀ , %	Коэффициент вариации CV (%)*
0.00	2,480	100,00%	2,06%
0.60	2,156	86,92%	1,54%
1.50	1,890	76,21%	0,59%
4.50	1,566	63,12%	1,11%
13.50	0,975	39,30%	0,67%
40.00	0,618	24,90%	5,08%

В таблице 2 приведены результаты проверки качества выпускаемой партии наборов. При постановке анализа полученные Вами результаты могут отличаться от приведенных выше, что является нормальным, при условии, что Ваши результаты соответствуют "Критериям приемлемости результатов" Таблица 1.

Специалист по контролю качества



Заключение: продукт соответствует требованиям ТУ ВУ 193208315.001-2019

Дата выдачи паспорта:

29.12.2023

ALGIMED
TECHNO

Телефон: +375 29 893 14 44
Почта: techno@algimed.com
Сайт: algimed-techno.com

ООО "Альгимед Техно"
220090, Республика Беларусь,
г. Минск, тр. Логойский, д.22,
корп.1, ком. 309